

MANUALE UTENTE
Tradotto da Life365 Italy S.p.A.

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

MODEL : ET01



Made in China

Inserimento e sostituzione batterie

Quando sul dispositivo viene mostrato il simbolo "B", è necessario sostituire le batterie.



Aprire il vano batterie come in figura e inserire due batterie AAA seguendo le indicazioni riportate sul coperchio del vano batterie.

[Note]
Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo per lunghi periodi. Smaltire le batterie correttamente.

Specifiche Tecniche

Termometro ad infrarossi - Modello ET05
Raggio di misurazione: 32.0°C ~ 43.0°C
Precisione: +/- 0.2°C (35.0°C ~ 42.0°)
+/- 0.3°C (meno di 35.0°C o più di 43.0°

C)
Batterie: 2x AAA (DC 3V) (Non incluse)
Slot in memoria: 32 Misurazioni
Spegnimento automatico: senza uso per 15 secondi
Peso senza batterie: 110g
Dimensioni: 150 x 95 x 44 mm
Sensibilità: 0.1°C
Temperatura di utilizzo: 10°C ~ 40°C
Umidità relativa: < 85% HR
Pressione atmosferica: (70~106)kPa
Temperatura di trasporto: -20°C ~ 50°C
Umidità relativa: 15%HR ~ 93%HR
Pressione atmosferica: (70~106)kPa

Norme di Sicurezza

- Per pulire il sensore utilizzare un batuffolo di cotone leggermente bagnato con alcol
- Prima di terminare la misurazione, attendere che il dispositivo emetta il segnale acustico

Procedura per una corretta misurazione

1

2

3

4

Accensione

Premere il tasto misurazione brevemente per accendere il dispositivo

Modalità di misurazione

Quando il termometro è acceso, premere brevemente SET per scegliere fra 'Misurazione corporea', o 'Misurazione superfici'

Unità di Misura

Tenere premuto il tasto SET per almeno tre secondi per cambiare l'unità di misura scegliendo °C o °F

Misurazione

Tenere il termometro a una distanza non inferiore a 1 cm e non superiore a 5 cm.

5

Spegnimento automatico dopo 15 secondi di inutilizzo

AVVERTENZE

Rispettare le indicazioni sulle condizioni atmosferiche adatte ad utilizzare o conservare il dispositivo.
Non usare prodotti corrosivi o gas per pulire il dispositivo.
Non utilizzare nei pressi di grandi campi elettromagnetici del tipo telefoni cellulari o cordless.
Tenere lontano da fonti di calore.
Non esporre alla luce del sole.
Non bagnare o fare entrare a contatto con liquidi.
Non utilizzare se il sensore appare rovinato.
Maneggiare con cura.

Warranty

(retained by customer)

Model:

Series No.:

Supplier:

Purchase time:

Year

Month

Day


Store Seal:

Year

Month

Day

- Maneggiare con cura: vibrazioni, urti o sporco possono danneggiare il sensore e causare perdita di precisione nello strumento
- Assicurarsi di chiudere correttamente il vano batterie prima di effettuare misurazioni
- Utilizzare nelle seguenti condizioni ambientali :
Temperatura : 10°C - 40°C
Umidità relativa : < 85%HR
- Trasportare nelle seguenti condizioni ambientali :
Temperatura : -20°C - 50°C
Umidità relativa : 15%HR - 93%HR
- La misurazione deve essere effettuata da un professionista, al fine di evitare misurazioni incorrette o imprecise

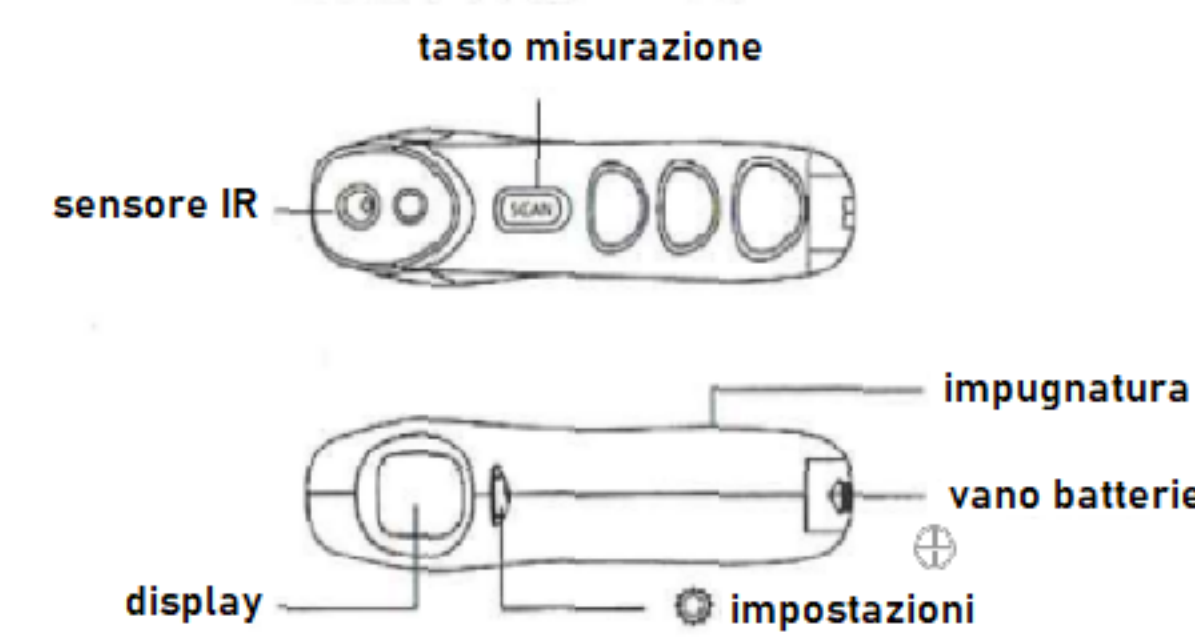


Compatibilità elettromagnetica

- Questo prodotto è conforme ai requisiti dello standard YY0505 compatibilità elettromagnetica
- Evitare forti campi elettromagnetici come quelli generati da apparecchi di telecomunicazione o microonde
- Consultare le tabelle sotto riportate per esigenze specifiche
- Utilizzare il termometro lontano da altri dispositivi
Qalora non fosse possibile informarsi sulle specifiche tecniche per evitare malfunzionamenti

EMC Tables:				
Guidance and manufacture's declaration-electromagnetic emissions				
The ET05 is intended for use int he electromagnetic environment specified below. The customer of the user of the ET05 should assure that it is used in such an environment.				
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment guidance		
RF emissions GB 4824	Group 1	The product uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.		
RF emissions GB 4824	Class B	The product is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies building used for domestic purpose.		
Harmonic emissions GB 17625.1	Not Applicable			
Voltage fluctuations/ Flicker emissions GB 17625.2	Not Applicable			
Interruptions and voltage variations on power supply input lines GB/T 17626.11	<5%Ut,for 0.5 cycle (>95% dip in UT) 40%Ut for 5 cycles (60% dip in UT) 70%Ut for 25 cycles (30% dip in UT) <5%Ut (>95% dip in UT) for 5 sec	Not Applicable	Not Applicable	
Power frequency (50/60Hz) GB/T 17626.8	3A/m	3A/m, 50/60Hz	Power frequency mag- netic fields should be at levels character-istic of a typical location in a typical commercial or hospital environment	
NOTE UT is the a.c.mains voltage prior to application of the test level				

Display

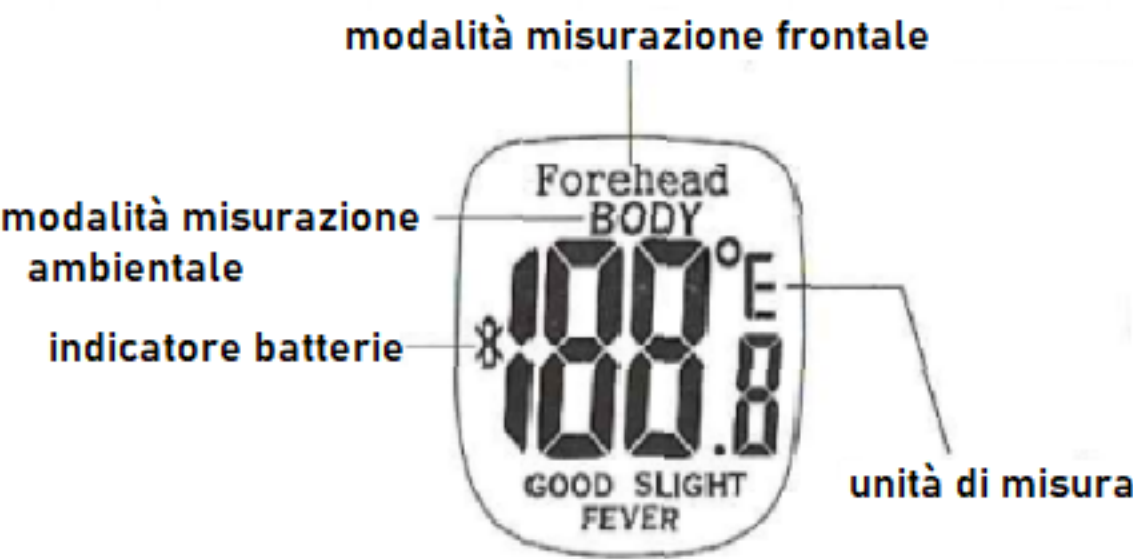


Scegliere fra 2 modalità

Questo dispositivo offre modalità misurazione frontale/corporea e modalità misurazione ambientale/oggetti.

Forehead: modalità misurazione frontale/corporea
BODY: modalità misurazione ambientale/oggetti


Premere brevemente il tasto 'settings' per cambiare la modalità di misurazione.

Norme per una corretta misurazione

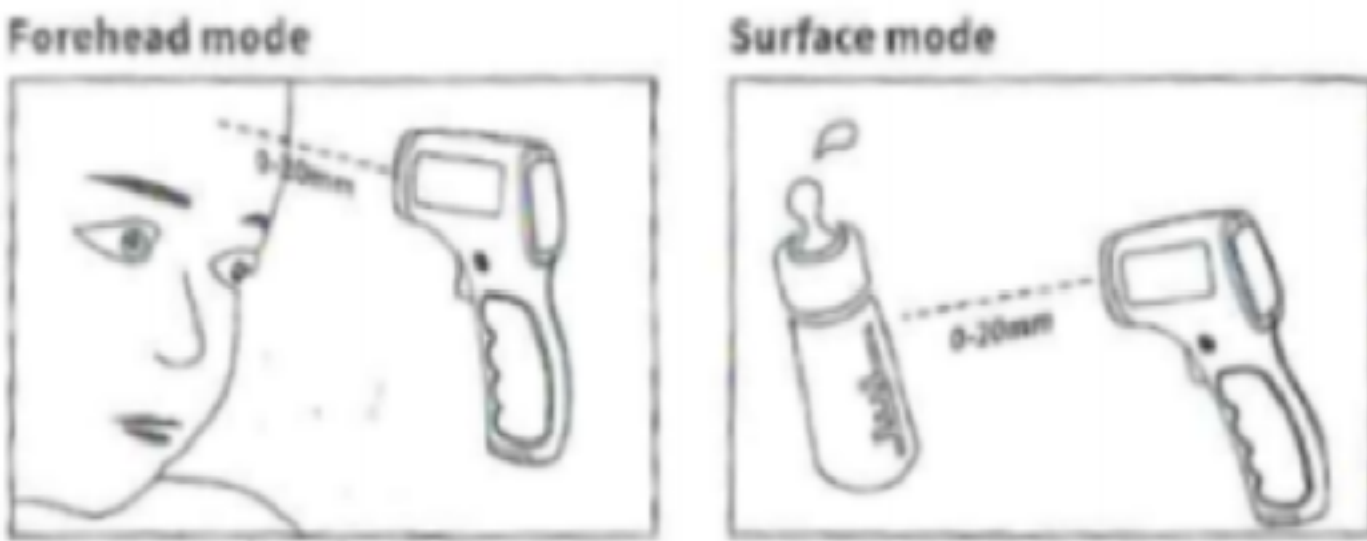

Selezione unità temperatura

Per cambiare l'unità di misura della temperatura scegliendo fra °C e °F , tenere premuto **settings** per tre secondi fino a che l'unità viene mostrata sul display

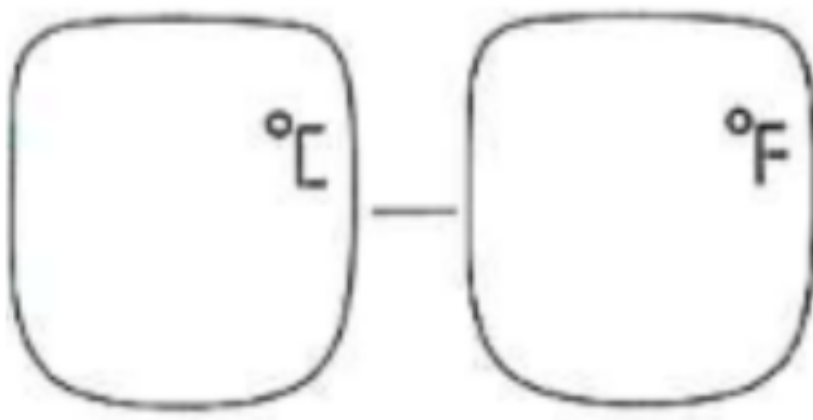

Memoria

In modalità 'Body mode', le ultime 32 temperature registrate vengono salvate in memoria.

Premere due volte il tasto settings per entrare nella ricerca dei dati in memoria e poi navigare fra i dati salvati come in figura sotto:



Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM			
The product s intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the product can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the product as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Immunity Test	IEC 60501 test level	Compliance level	Electromagnetic environ- ment guidance
Rated maximum output power of transmitter/W	The spacing distance corresponding to different frequencies of the transmitter/M		
	150kHz~80MHz d=1.2√P	80MHz~800MHz d=1.2√P	800MHz~2.5GHz d=2.3√P
	0.01	Not Applicable	0.12
	0.1	Not Applicable	0.38
	1	Not Applicable	1.2
	10	Not Applicable	3.8
	100	Not Applicable	12
			23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz the separation distance for the higher frequency range applies NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

Descrizione delle sostanze pericolose

The name and content of harmful substances in the product

Component	Hazardous substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Package material	O	O	O	O	O	O
Cell	Alkaline battery	O	O	O	O	O
	Li battery	X	X	O	O	O
Remark	This form has been prepared in accordance with SJ/T 11364. O: Indicates that the content of the harmful substance in all homo- geneous materials of the component is specified limit of GB/T 26572 is as follows. X: Indicates the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component Exceed the limit stipulated by GB/T 26572.					